

dProfitrode



6.00204.300

Manuel d'utilisation du capteur

8.0109.8005FR / 2022-08-29



Metrohm AG
Ionenstrasse
CH-9100 Herisau
Suisse
+41 71 353 85 85
info@metrohm.com
www.metrohm.com

dProfitrode

6.00204.300

Manuel d'utilisation du capteur

8.0109.8005FR /
2022-08-29

La présente documentation est protégée par les droits d'auteur. Tous droits réservés.

La présente documentation a été élaborée avec le plus grand soin. Cependant, des erreurs ne peuvent être totalement exclues. Veuillez communiquer vos remarques à ce sujet directement à l'adresse citée ci-dessus.

Exclusion de la responsabilité

Les défauts résultant de circonstances dont Metrohm n'est pas responsable, p. ex. stockage inapproprié, utilisation non conforme etc., sont expressément exclus de la garantie. Les modifications non autorisées du produit (par exemple, transformations ou ajouts) excluent toute responsabilité du fabricant pour les dommages qui en résultent et leurs conséquences. La documentation du produit Metrohm fournit des instructions et remarques à respecter strictement. Dans le cas contraire, la responsabilité de Metrohm est exclue.

[illegible][illegible]

1 Aperçu

1.1 dProfitrode – Description du produit

La dProfitrode est une électrode de verre de mesure du pH combinée destinée à effectuer des mesures dans les milieux difficiles. La dProfitrode est une dTrode (électrode numérique) pour OMNIS.

1.2 dProfitrode – Aperçu

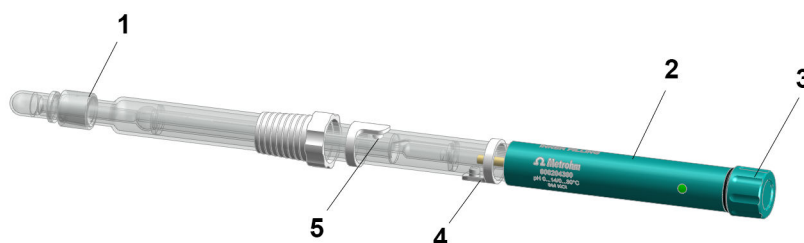


Figure 1 dProfitrode

1 Diaphragme rodé

Amovible.

3 Capuchon protecteur

5 Orifice de remplissage

Pour l'électrolyte intérieur.

2 Tête de l'électrode

4 Orifice de remplissage

Pour l'électrolyte extérieur.

2 Description fonctionnelle

2.1 Électrode pH – description fonctionnelle

La membrane de verre de l'électrode pH est constituée d'une structure basique de silicate qui contient des ions de lithium. Si la surface en verre est immergée dans une solution aqueuse, une mince couche gonflante (couche de gel) se forme à l'extérieur et à l'intérieur de la surface en verre.

Un état stationnaire est atteint à l'intérieur de la membrane de verre en raison de la concentration de protons constante (pH 7) dans le tampon intérieur de l'électrode pH. Si la concentration de protons change dans la solution de mesure, un échange d'ions s'effectue dans la couche de gel extérieure et provoque une modification du potentiel de la membrane de verre. Le potentiel de l'électrode pH ne devient à son tour constant que lorsque cet échange d'ions a atteint un état stationnaire.

3 Livraison et emballage

3.1 Livraison

Contrôler immédiatement les points suivants à la réception de la livraison :

- Vérifier son intégralité à l'aide du bon de livraison.
- Vérifier que le produit n'est pas endommagé.
- Si la livraison est incomplète ou endommagée, veuillez contacter votre représentant Metrohm local.

3.2 Emballage

Le produit et les accessoires sont livrés dans un emballage protecteur spécial. Conserver impérativement cet emballage afin de garantir un transport sécurisé du produit. Si une vis de sécurité de transport est présente, la conserver et la réutiliser également.

3.3 Déballer et vérifier l'électrode

1 Déballer l'électrode

Déballer l'électrode avec le récipient de conservation.

2 Enlever le récipient de conservation

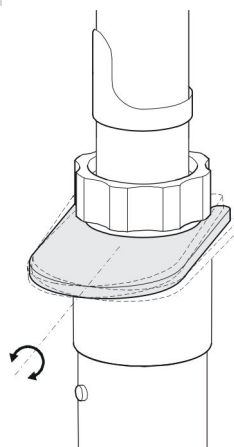


Figure 2 Séparer l'électrode du récipient de conservation

- D'une main, saisir l'électrode et le récipient de conservation de manière à ne pas laisser glisser l'électrode.



- Positionner l'outil entre le récipient de conservation et la douille de rodage.
- Basculer l'outil avec **prudence** sur le côté jusqu'à ce que l'électrode se détache.

Ne pas basculer l'outil en avant !

 Éviter une pression excessive sur l'outil. L'électrode pourrait sinon se détacher de manière trop brusque.

3 Vérifier le fonctionnement de l'électrode

- **Préparer l'électrode :**
(voir "", Chapitre , page 0)
- **Calibrer l'électrode :**
(voir "Calibrer l'électrode pH", Chapitre 4.1, page 6)

 Les électrodes défectueuses doivent être retournées dans les deux mois (suivant la date de livraison) pour contrôler si la garantie est applicable.

3.4 Conserver l'dProfitrode



ATTENTION

Dégât matériel dû au capteur asséché

Destruction par assèchement du capteur.

- Ne jamais laisser le capteur s'assécher.
- Observer les consignes de conservation.

Afin de protéger la tête de l'électrode de l'eau, de solvants, de la poussière et des influences mécaniques, elle doit être conservée de la manière suivante :

- 1 Visser le capuchon protecteur sur la tête de l'électrode .
- 2 Conserver l'électrode dans le récipient de conservation. Il importe de s'assurer que l'électrode immerge dans la solution de conservation via le diaphragme rodé amovible .

Il est conseillé d'utiliser la solution de conservation uniquement pour cet électrolyte, pour tous les autres électrolytes nous recommandons le stockage dans l'électrolyte intermédiaire.

3

4 Fonctionnement et contrôle

4.1 Calibrer l'électrode pH

- 1** Rincer l'électrode à l'eau distillée.
- 2 Calibrer l'électrode avec le premier tampon**
Plonger l'électrode dans la solution de tampon (pH 7) et lancer le calibrage.
- 3** Une fois la mesure effectuée, sortir l'électrode du tampon et la rincer avec de l'eau distillée.
- 4 Calibrer l'électrode avec le deuxième tampon**
Répéter les étapes 2 et 3 avec le deuxième tampon.
- 5 Si nécessaire, calibrer l'électrode avec le troisième tampon**
Répéter les étapes 2 et 3 avec le troisième tampon.
- 6** Sur la base des informations suivantes, décider si l'électrode satisfait aux exigences :
 - **Pente :**
95 à 103 %
 - **pH :**
6,5 à 7,5
 - **Potentiel de décalage :**
-30 à 30 mV

5 Maintenance

5.1 dProfitrode – remplacer l'électrolyte


- 1 Ouvrir les orifices de remplissage et .
- 2 Coulisser le diaphragme rodé amovible vers le bas et laisser s'écouler l'électrolyte intermédiaire. Appuyer ensuite le diaphragme rodé vers le haut.
- 3 Rincer l'alvéole d'électrolyte intermédiaire avec l'électrolyte neuf.
- 4 Remplir l'électrode d'électrolyte jusqu'aux orifices de remplissage.
- 5 Obturer les orifices de remplissage et si l'électrode n'est pas utilisée immédiatement.
- 6 Conserver l'électrode immergée dans la solution de conservation pendant la nuit.
L'électrode peut ensuite être à nouveau utilisée.

5.2 Nettoyer une électrode pH

- 1  Ne jamais traiter l'électrode en bain à ultrasons. Cela pourrait endommager l'électrode.
Rincer l'électrode à l'eau distillée.

[illegible]

7 Électrode pH – élimination



Ce produit est soumis à la directive européenne DEEE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment).

L'élimination correcte du produit usagé réduit les effets néfastes sur l'environnement et la santé.

1 Vider l'électrolyte

Desserrer le diaphragme rodé et laisser s'écouler l'électrolyte.

2 Éliminer l'électrolyte

Éliminer l'électrolyte conformément aux dispositions locales.

3 Mettre au rebut l'électrode

Recycler l'électrode dans les déchets électroniques.

Les autorités locales, les services d'élimination des déchets ou encore les revendeurs fournissent des informations plus détaillées concernant l'élimination.

8 Spécifications techniques

8.1 Conditions ambiantes

Gamme nominale de fonctionnement +5 à +45 °C

à une
humidité relative de l'air
de 80 % max., sans
condensation

Stockage +5 à +45 °C

8.2 Électrode pH – caractéristiques

Dimensions

<i>Diamètre de la tige</i>	12 mm
<i>Longueur de montage maximale</i>	125 mm

8.3 Électrode pH – boîtier

Matériaux

<i>Matériau de tige</i>	Verre
-------------------------	-------

8.4 Électrode pH – spécifications des connecteurs

Connecteur

Tête enfichable
Metrohm Q

8.5 dTrodes – Spécifications de l'écran d'affichage

Voyant d'état LED vert-rouge

8.6 dProfitrode – Spécifications de mesure

Gamme de pH 0 à 14

Gamme de température

À court terme 0 à 100 °C

À long terme 0 à 80 °C

Profondeur d'immersion minimale 30 mm