


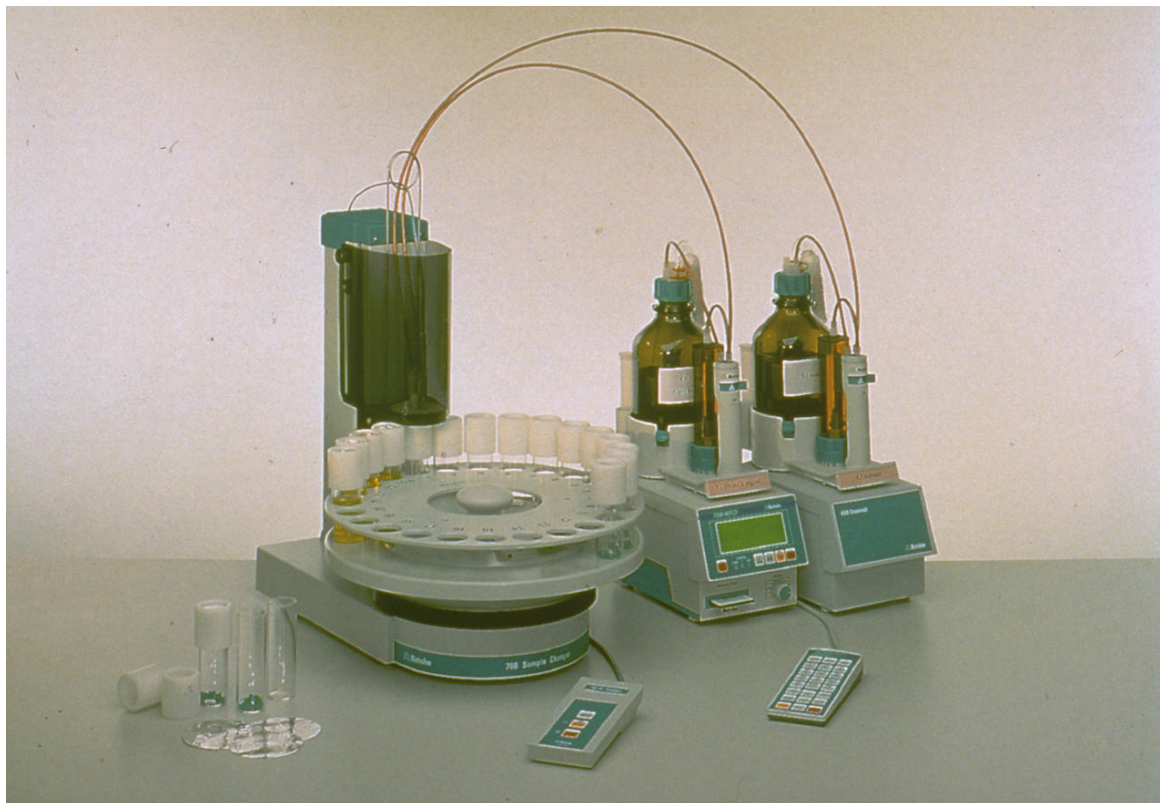

Probenwechsler KFT 760

2.760.0020

Komplettsystem für die automatische volumetrische Karl Fischer Titration.

Lieferumfang 2.760.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2752.010	Steckerabdeckung
		Für den 717, 730, 760 Sample Changers, IC Sample Processors, 774 Oven Sample Processor




1 STK

1.741.0010

741 Magnetic Stirrer

Magnetrührer für Probenwechsler.

Der Magnetrührer wird unterhalb des Probenracks angebracht.

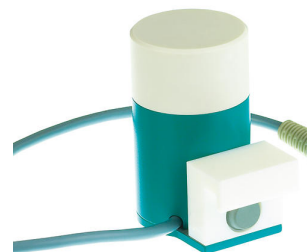

1 STK

6.0340.000

Doppel-Pt-Draht-Elektrode für Probenwechsler
(Fixkabel)

Indikatorelektrode (Durchmesser = 5.3 mm, Fixkabel 2 m), die für automatisierte Karl-Fischer-Titration verwendet wird.



24 STK

6.1432.210

Probenbecher aus Klarglas 75 mL, 1 Stück

Probenbecher aus Klarglas 75 mL, passend zu Probenracks 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 und 6.2041.900, 1 Stück



1 STK

6.1458.030

KF-Titrierkopf / 4 x M10-Anschlüsse

Mit 4 Schraubnippeln M10, inkl. Stopfen.



2 STK

6.1805.110

FEP-Schlauch / M6 / 80 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1815.010

Spiralband / 0.5 m

Zum Zusammenhalten verschiedener Kabel oder Schläuche.



1 STK

6.1821.000

Absaugrohr

Für KF Probenwechsler



24 STK

6.1903.010

Rührstäbchen / 12 mm

Rührstäbchen mit magnetischem Kern, Umhüllung aus PTFE, 12 mm lang



24 STK

6.2037.040

Folienhalter

Folienhalter zu 75 mL Probenbecher für Karl Fischer Probenwechsler



1 STK

6.2041.340

Probenrack, 24 x 75 mL, (PVC)

Probenrack zu 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend für 24 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.1432.210, 6.1459.400.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)



1 STK

6.2820.000

Al Folie

1000 Rondellen mit 80 mm Durchmesser. Folienstärke: 0,010 mm
Zusammen mit Folienhalter 6.2037.030 zu Probenbecher 6.1432.210. Für 674 KF Sample Changer

