


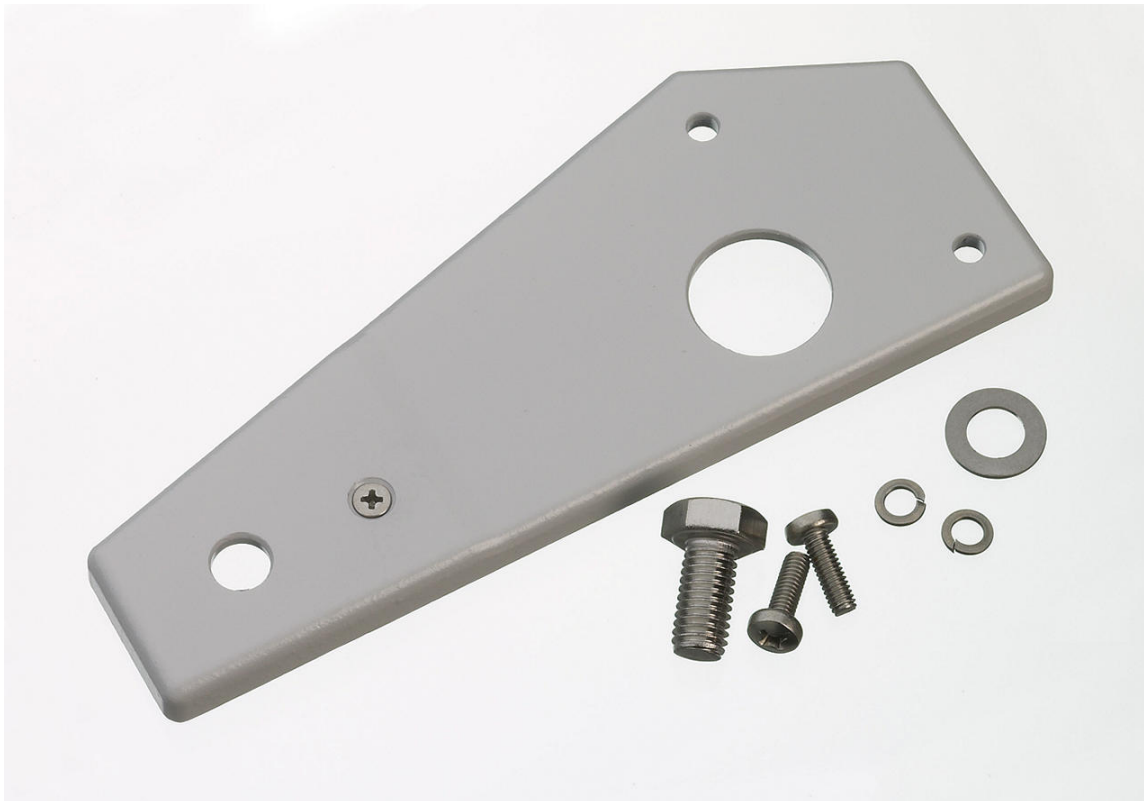

Stativkonsole ohne Stativstange

6.2001.050

Für 756, 831 KF Coulometer und 728 Magnetic Swing-out Stirrer

Lieferumfang 6.2001.050

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2621.100	Inbusschlüssel 3 mm für IC Sample Processors



