


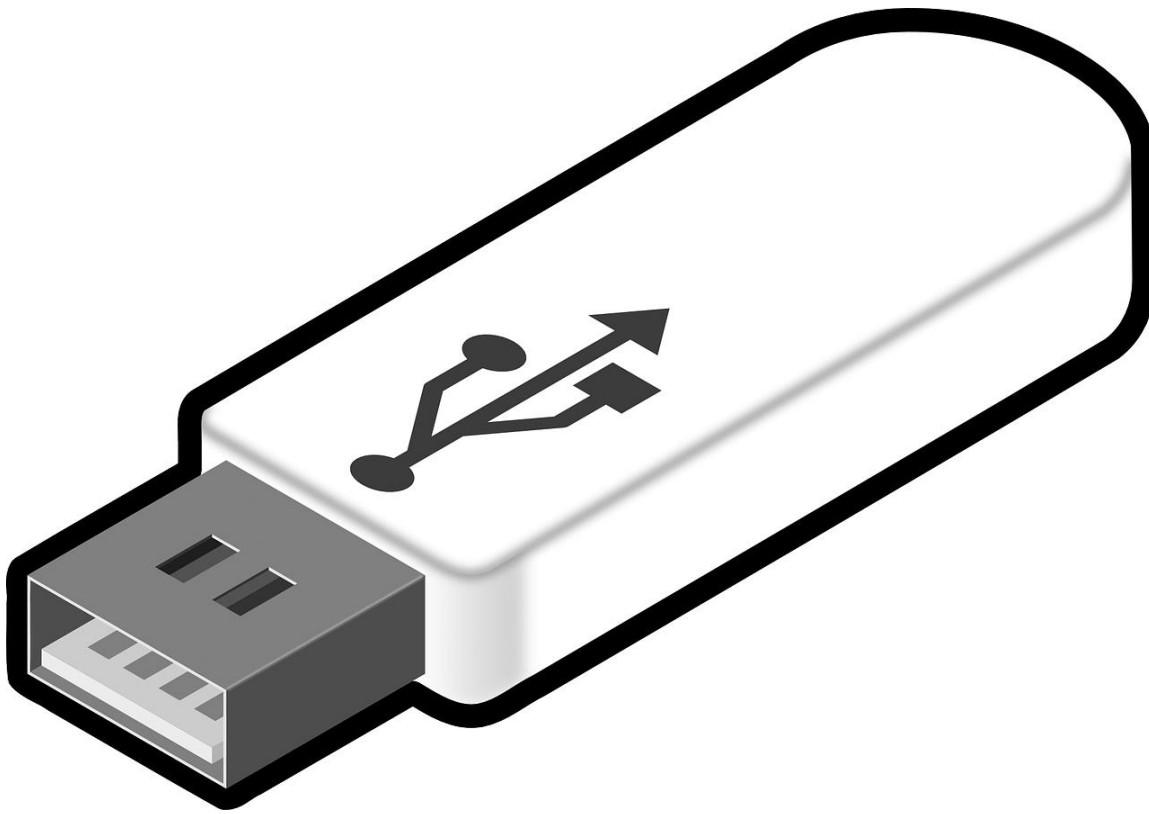

Metrohm IC Driver 1.0, ICP-MS MassHunter

6.6090.100

Software-Treiber zum Einbinden von Metrohm IC-Geräten in Agilent`s ICP-MS MassHunter Software 5.3 und höher.

Lernen Sie mehr über die Kopplung von IC und Massenspektrometern

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2148.010	Remote Box MSB Zusätzliche Remote-Schnittstelle für den Anschluss von Geräten, die via Remote-Leitungen gesteuert werden können. Mit Fixkabel.



IC-Ausrüstung für die Verbindung und bidirektionale Steuerung von
Metrohm IC und Agilent ICP-MS (IC-ICP/MS)

