


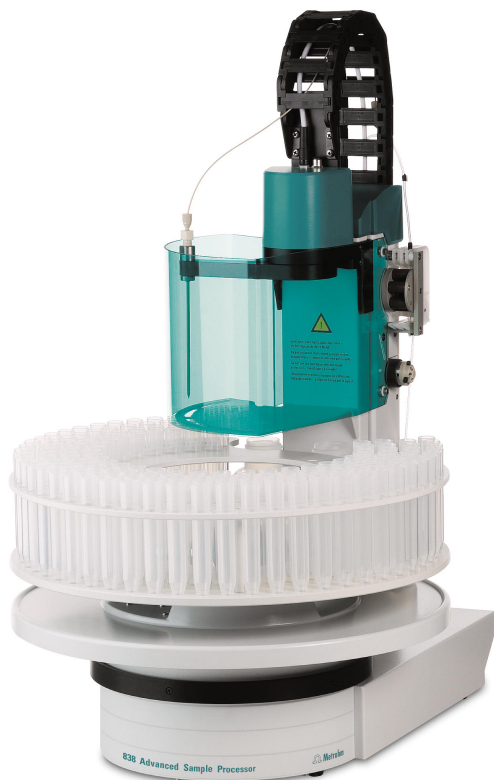

838 Advanced IC Sample Processor

2.838.0010

Procesador de muestras CI Advanced en versión estándar.

Partes/accesorios 2.838.0010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.838.0010	838 Advanced IC Sample Processor

Procesador de muestras CI Advanced en versión estándar.



Recipiente de lavado para Cambiadores de muestras CI.



1 PCS

6.1831.050

Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 40 cm

Para diálisis «inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler



2 PCS

6.1831.060

Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 1 m

Para diálisis inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



1 PCS

6.2064.000

Sujetador de vasos para Procesador de muestras CI Advanced

Placa para quitar las tapas de los tubos sobre el Procesador de muestras Advanced. Para recipientes de muestras de 2,5 y 11 mL



1 PCS

6.2134.100

Cable de conexión RS-232, 5 m, DB9 – DB9

Para conexión Interface Metrohm RS-232 - Titrino, 756 KF Coulometer, 762 o 771 IC Interfaces, 790 Personal IC, 743 Rancimat, 763 PVC Thermomat, 873 Biodiesel Rancimat.



1 PCS

6.2141.190

Cable 732/819 - 766/788/838

Cable de conexión Detector CI a Advanced Sample Processor



1 PCS

6.2621.300

Juego de herramientas para IC Sample Processor
Advanced

Herramienta formada por llave de horquilla y llave hexagonal



1 PCS

6.2739.000

Llave

Para apretar conexiones



1 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2744.034

Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.




1 PCS

6.2744.160

Unión de tubo flexible de bomba con seguro

Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva

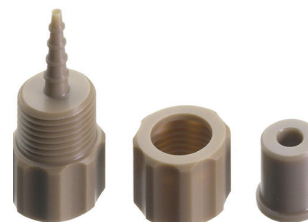


1 PCS

6.2751.110

Cubierta de seguridad

Cubierta de seguridad para los Advanced IC/VA Sample Processor.



2 PCS

6.1826.360

Tubo flexible de bomba LFL (blanco/blanco) con 3 fijaciones

Para cambiadores de muestras.



1 PCS

6.2846.010

Aguja de muestras de dióxido de zirconio con punta de titulación PEEK

Aguja de muestras para Sample Processors y Autosampler en la cromatografía iónica. La punta de titulación PEEK garantiza una perforación segura de la tapa del vial.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1562.130	Tubo de transferencia con soporte 2 x M6 / 10 mL para procesadores de muestras Tubo de transferencia para dilución de muestras y concentración con el Dosino en procesadores de muestras.	
6.2041.310	Gradilla de muestras, 12 x 250 mL (PVC) Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 12 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250. Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	
6.2041.320	Gradilla de muestras, 16 x 150 mL (PVC) Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 16 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: vaso de 150 mL (de forma alta). Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	
6.2041.340	Gradilla de muestras, 24 x 75 mL (PVC) Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400. Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	

6.2041.350

Gradilla de muestras 48 x 75 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 48 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)




6.2041.360

Gradilla de muestras 12 x 150 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 12 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: vaso de 150 mL (de forma alta), 6.1459.310.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

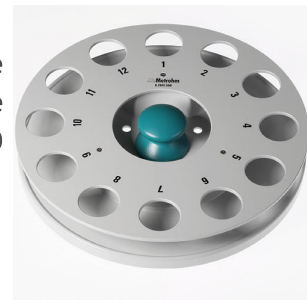

6.2041.370

Gradilla de muestras, 14 x 200 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 14 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.310.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.380

Gradilla de muestras 14 x 235 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor y 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 14 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 235 mL (8 oz.).

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.430

Gradilla de muestras 127 x 11 mL y 2 x 300 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 127 recipientes de muestras y 2 botellas de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botellas de lavado: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.440

Gradilla de muestras, 148 x 11 mL y 3 x 300 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor y 815 Robotic USB Sample Processor XL, apta para 148 recipientes de muestras y 3 botellas de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botellas de lavado: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.450

Gradilla de muestras, 56 x 11 mL y 56 x 50 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor y 815 Robotic USB Sample Processor XL, apta para 112 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, viales Sarstedt de 50 mL.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.760

Gradilla de muestras 54 x 11 mL + 1 x 300 mL

Gradilla de muestras con pequeño diámetro para recipientes de muestras de 54 x 11 mL en dos filas y una botella adicional de 1 x 300 mL.



Para Sample Processors.



2,5 mL. 2000 unidades. Para Sample Processors para CI.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje tienen lugar en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



2,5 mL. 200 unidades. Para Sample Processors para CI.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



2000 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2743.057

Recipiente de muestras 11 mL

200 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2743.070

Tapón con perforación

2000 unidades. Para procesadores de muestras CI



6.2743.077

Tapón con perforación

200 unidades. Para procesadores de muestras CI

