



838 Advanced IC Dialysis Sample Processor

2.838.0110

Procesador de muestras CI Advanced para diálisis inline.

Partes/accesorios 2.838.0110

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.838.0010	838 Advanced IC Sample Processor

Procesador de muestras CI Advanced en versión estándar.



1 PCS

6.1602.150

Adaptador para botella / GL 45 - 3 x UNF 10/32

Para conexión de tubo capilar de 1/16". Se usa con soluciones auxiliares MSM y en la diálisis inline.



1 PCS

6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45



3 PCS

6.1608.080

Botella / 300 mL

Recipiente de lavado para Cambiadores de muestras CI.



6 PCS

6.1803.040

Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i., 1 m

Tubo capilar para manipulación de muestras en la CI.



1 PCS

6.1803.100

Capilar PTFE 0.5 mm d.i. / 40 cm

Tubo capilar para filtración y diálisis



1 PCS

6.1831.050

Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 40 cm

Para diálisis «inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler



1 PCS

6.1831.060

Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 1 m

Para diálisis inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



1 PCS

6.2057.010

Soporte para celda de diálisis

Para la celda de diálisis en el espacio de columnas CI



1 PCS

6.2064.000

Sujetador de vasos para Procesador de muestras CI
Advanced

Placa para quitar las tapas de los tubos sobre el Procesador de muestras
Advanced. Para recipientes de muestras de 2,5 y 11 mL



1 PCS

6.2134.100

Cable de conexión RS-232, 5 m, DB9 – DB9

Para conexión Interface Metrohm RS-232 - Titrino, 756 KF Coulometer,
762 o 771 IC Interfaces, 790 Personal IC, 743 Rancimat, 763 PVC
Thermomat, 873 Biodiesel Rancimat.



1 PCS

6.2141.190

Cable 732/819 - 766/788/838

Cable de conexión Detector CI a Advanced Sample Processor



1 PCS

6.2621.300

Juego de herramientas para IC Sample Processor
Advanced

Herramienta formada por llave de horquilla y llave hexagonal



1 PCS

6.2714.010

Membrana de diálisis (acetato de celulosa)

Tamaño nominal de poros: 0.2 µm. Kit de 50 unidades. Para diálisis inline



1 PCS

6.2729.100

Celda de diálisis

Incl. 4 tapones ciegos 6.2744.060. Para diálisis inline



1 PCS

6.2739.000

Llave

Para apretar conexiones



1 PCS

6.2744.000

Tornillo de presión de PVDF

Con conexión UNF 10/32 . Para aparatos CI, diálisis inline (conexión de capilares de PTFE)



2 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2744.034

Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.




2 PCS

6.2744.160

Unión de tubo flexible de bomba con seguro

Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva

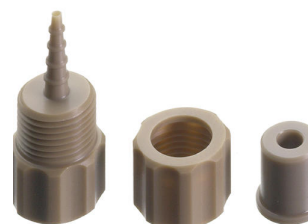


1 PCS

6.2751.110

Cubierta de seguridad

Cubierta de seguridad para los Advanced IC/VA Sample Processor.



1 PCS

6.2831.010

Pincita de plástico

Para la diálisis y membranas de filtración



2 PCS

6.1826.340

Tubo flexible de bomba LFL (negro/negro) con 3 fijaciones

Para solución de muestra en diálisis en línea.



1 PCS

6.2846.010

Aguja de muestras de dióxido de zirconio con punta de titulación PEEK

Aguja de muestras para Sample Processors y Autosampler en la cromatografía iónica. La punta de titulación PEEK garantiza una perforación segura de la tapa del vial.




2 PCS

6.1826.420

Tubo de bomba PharMed® (naranja/amarillo) 3 topes

Para regeneración MSM con bomba peristáltica.

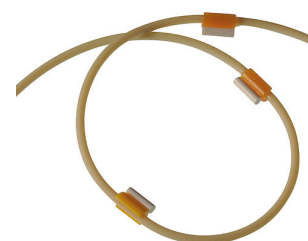

Accesorios opcionales


Order no.	Descripción	
6.2041.310	Gradilla de muestras, 12 x 250 mL (PVC) Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 12 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250. Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	
6.2041.320	Gradilla de muestras, 16 x 150 mL (PVC) Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 16 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: vaso de 150 mL (de forma alta). Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	
6.2041.340	Gradilla de muestras, 24 x 75 mL (PVC) Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400. Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	
6.2041.350	Gradilla de muestras 48 x 75 mL (PVC) Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 48 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400. Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)	

6.2041.360

Gradilla de muestras 12 x 150 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 12 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: vaso de 150 mL (de forma alta), 6.1459.310.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

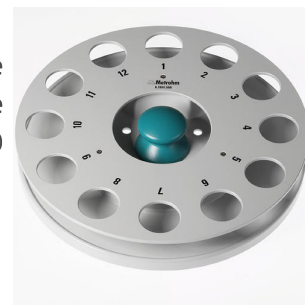


6.2041.370

Gradilla de muestras, 14 x 200 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 14 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.310.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

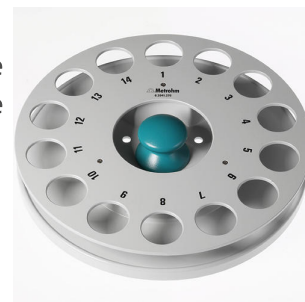

6.2041.380

Gradilla de muestras 14 x 235 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor y 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 14 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 235 mL (8 oz.).

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.430

Gradilla de muestras 127 x 11 mL y 2 x 300 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler "Basic", apta para 127 recipientes de muestras y 2 botellas de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botellas de lavado: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.440 Gradilla de muestras, 148 x 11 mL y 3 x 300 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor y 815 Robotic USB Sample Processor XL, apta para 148 recipientes de muestras y 3 botellas de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botellas de lavado: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.


Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



6.2041.450 Gradilla de muestras, 56 x 11 mL y 56 x 50 mL, (PVC)

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor y 815 Robotic USB Sample Processor XL, apta para 112 recipientes de muestras. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras: 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, viales Sarstedt de 50 mL.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

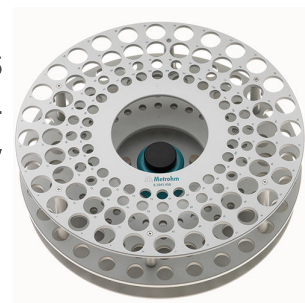

6.2041.760 Gradilla de muestras 54 x 11 mL + 1 x 300 mL

Gradilla de muestras con pequeño diámetro para recipientes de muestras de 54 x 11 mL en dos filas y una botella adicional de 1 x 300 mL.



6.2629.000 Tuerca para portaagujas de CI

Para Sample Processors.



6.2743.050

Recipiente de muestras 11 mL

2000 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2743.057

Recipiente de muestras 11 mL

200 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2743.070

Tapón con perforación

2000 unidades. Para procesadores de muestras CI



6.2743.077

Tapón con perforación

200 unidades. Para procesadores de muestras CI

