



863 Compact IC Autosampler

2.863.0010

El 863 Compact IC Autosampler es la ayuda ideal para los análisis de rutina. Con él se pueden automatizar los diferentes instrumentos de cromatografía iónica de Metrohm.

Partes/accesorios 2.863.0010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.863.0010	863 Compact IC Autosampler

El 863 Compact IC Autosampler es la ayuda ideal para los análisis de rutina. Con él se pueden automatizar los diferentes instrumentos de cromatografía iónica de Metrohm.



2 PCS 6.1826.360 Tubo flexible de bomba LFL (blanco/blanco) con 3 fijaciones

Para cambiadores de muestras.



1 PCS 6.1831.050 Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 40 cm

Para diálisis «inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler



1 PCS 6.1831.060 Tubo capilar de PEEK, 0.5 mm d.i., 1 m

Para diálisis inline y para cambiadores de muestras. Para IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



1 PCS 6.2151.100 Adaptador USB Mini (OTG) - USB A

Para conexión de aparatos USB.



1 PCS

6.2151.110

Cable USB MINI (OTG) - USB A, 1.8 m

Para conexión de aparatos USB.



1 PCS

6.2621.090

Llave de boca 1/2 in.

Para tornillos 1/2 in. Para Procesadores de muestras CI



1 PCS

6.2621.130

Llave hexagonal 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.2621.140

Llave hexagonal 2.5 mm



1 PCS 6.2739.000 Llave
Para apretar conexiones



1 PCS 6.2743.057 Recipiente de muestras 11 mL

200 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



1 PCS 6.2743.077 Tapón con perforación

200 unidades. Para procesadores de muestras CI



1 PCS 6.2744.034 Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.



1 PCS

6.2744.070

Tornillo de presión corto

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK




1 PCS

6.2744.160

Unión de tubo flexible de bomba con seguro

Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva

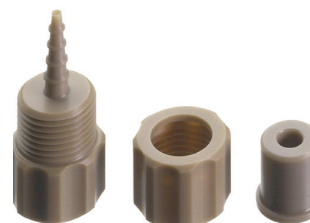

1 PCS

6.2833.030

Soporte de aguja 1/8 in. para 863
Compact Autosampler

Soporte de aguja 1/8 in. para 863 Compact Autosampler



1 PCS

6.2846.010

Aguja de muestras de dióxido de zirconio con punta
de titulación PEEK

Aguja de muestras para Sample Processors y Autosampler en la cromatografía iónica. La punta de titulación PEEK garantiza una perforación segura de la tapa del vial.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1826.310	Tubo de bomba LFL (naranja/verde), 3 topos Tubo de bomba para soluciones supresoras y para la solución aceptora para diálisis inline y ultrafiltración inline.	
6.1826.320	Tubo de bomba LFL (naranja/amarillo), 3 topos Para soluciones supresoras y para la solución aceptora para diálisis inline y ultrafiltración inline.	
6.1826.330	Tubo flexible de bomba LFL (naranja/blanco) con 3 fijaciones Para todos los aparatos CI con bomba peristáltica.	
6.1826.340	Tubo flexible de bomba LFL (negro/negro) con 3 fijaciones Para solución de muestra en diálisis en línea.	

6.1826.380 Tubo flexible de bomba LFL (gris/gris) con 3 fijaciones
Para la dilución en línea.



6.1826.390 Tubo flexible de bomba LFL (amarillo/amarillo) con 3 fijaciones
Para la solución de la muestra en la filtración en línea.



6.2141.230 Cable de conexión «remote» ; Cambiador de Muestras
Compact ; - Titrino plus/Pump Station

Cable para conexión a distancia entre Compact Sample Changer
/Compact Autosampler y Titrino plus y/o Pump Station.



6.2141.270 Cable Compact IC Autosampler - conexión «remote» en aparatos CI

Permite el control del Compact IC Autosampler a través de señales
«remote» de otros aparatos CI



6.2151.020

Cable USB A - USB B / 1.8 m

Cable de conexión USB



6.2629.000

Tuerca para portaagujas de CI

Para Sample Processors.



6.2723.310

Cubierta protectora para Titrino Plus

Cubierta protectora para pantalla y teclado para todos los aparatos de la familia Titrino plus.

Adecuado para: 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF-Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus y 899 Coulometer.



6.2743.040

Vial de PP, 2,5 mL, 2000 unidades

2,5 mL. 2000 unidades. Para Sample Processors para CI.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje tienen lugar en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2743.047

Vial de PP, 2,5 mL, 200 unidades

2,5 mL. 200 unidades. Para Sample Processors para CI.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.



6.2743.050

Recipiente de muestras 11 mL

2000 unidades. Para Sample Processors para CI y Autosampler para VA.

Los recipientes de muestras de CI están fabricados con plástico de polipropileno (PP) para aplicaciones sanitarias. La producción y el embalaje se realizan en condiciones estériles y de sala limpia (clase 7 de sala limpia, según la norma DIN ISO 14644). Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.

