


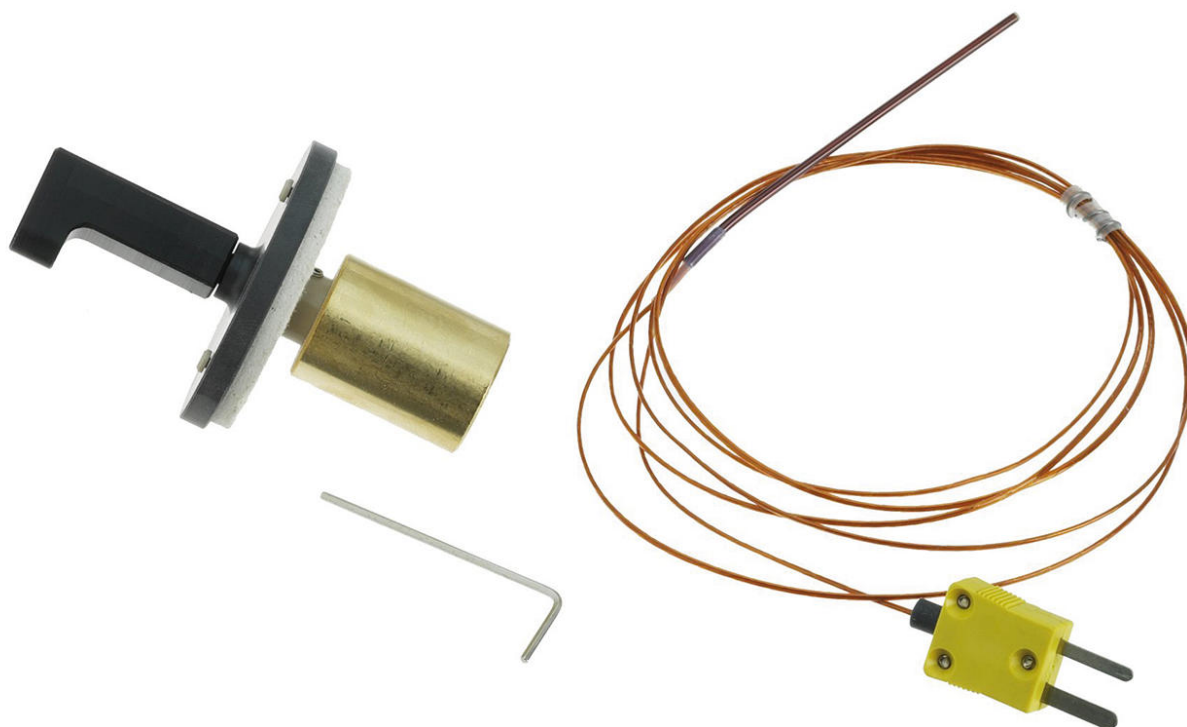

Equipo de medida para control de temperatura

6.5618.000

Equipo de medida para controlar la temperatura del 774 Oven Sample Processor, 832, 860 Thermoprep.

Partes/accesorios 6.5618.000

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2621.120	Llave de hexágono interior 1.5 mm



1 PCS

6.1253.010

Pieza de inserción de medida

Para controlar la temperatura del horno del 774 Oven Sample Processor

