


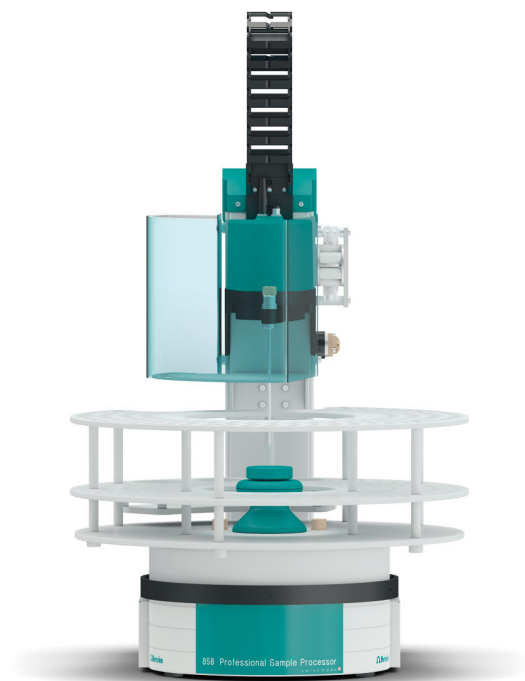

858 Professional Sample Processor – Pump – Injector

2.858.0030

L'858 Professional Sample Processor – Pump – Injector per il trattamento di campioni con volumi compresi tra 500 µL e 500 mL. Il trasferimento del campione avviene o attraverso la pompa peristaltica bidirezionale a doppio canale integrata o tramite un 800 Dosino. Inoltre è disponibile una valvola di iniezione a sei vie per la preparazione del campione.

Parti incluse 2.858.0030

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.858.0030	858 Professional Sample Processor – Pump – Injector
L'858 Professional Sample Processor – Pump – Injector per il trattamento di campioni con volumi compresi tra 500 µL e 500 mL. Il trasferimento del campione avviene o attraverso la pompa peristaltica bidirezionale a doppio canale integrata o tramite un 800 Dosino. Inoltre è disponibile una valvola di iniezione a sei vie per la preparazione del campione.		



3 PCS

6.1608.080

Bottiglia / 300 mL

Recipiente di lavaggio per IC Sample Processors.



1 PCS

6.1803.030

Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 3 m

Capillari per dialisi in linea, per Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor,
IC Liquid Handling Dialysis Unit




1 PCS

6.1825.210

Loop di campionamento in PEEK 20 µL

Per la valvola di iniezione, con 2 viti di fissaggio in PEEK



2 PCS

6.1826.360

Tubi di pompaggio LFL (bianco/bianco), 3 stopper

Per Sample Processors



1 PCS

6.1831.010

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d. / 3 m

Per tutti i componenti IC



1 PCS

6.1831.060

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 1 m

Per dialisi in linea e per Sample Changers. Per IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



1 PCS

6.1831.160

Capillari PEEK 0,5 mm diam. int. / 70 cm



1 PCS

6.2064.000

Beaker per Advanced IC Sample Processor

Piastra per 838 Advanced Sample Processors. Per tenere vial da 2.5 o 11 mL.



1 PCS

6.2151.000

Cavo USB A – Mini-DIN a 8 poli

Cavo controller.



1 PCS

6.2621.300

Kit di attrezzi per Advanced IC Sample Processors

Set di attrezzi costituito da chiave inglese e chiave esagonale



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



1 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.034

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.



1 PCS

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.



1 PCS

6.2744.110

Adattatore PEEK per tubo flessibile della pompa - filtro inline

Collegamento tra tubo flessibile della pompa e filtro inline




2 PCS


6.2744.160

Accoppiatore/UNF 10/32 con dispositivo di sicurezza

Dispositivo di sicurezza per il collegamento di un tubo di pompaggio ad un ugello

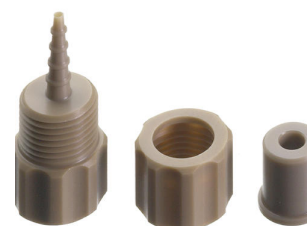

Protezione dagli schizzi per Sample Processor Advanced IC/VA.



Ago per campioni per Sample Processor e Autosampler nella cromatografia ionica. La punta in PEEK garantisce una foratura sicura della copertura del vial.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1826.310	Tubo flessibile LFL (arancione/verde), 3 stopper Tubo di pompaggio per soluzioni del soppressore e per la soluzione accettore nella dialisi in linea e l'ultrafiltrazione in linea.	
6.1826.320	Tubo di pompaggio LFL (arancione/giallo), 3 stopper Per soluzioni del soppressore e per la soluzione accettore nella dialisi in linea e l'ultrafiltrazione in linea.	
6.1826.330	Tubi di pompaggio LFL (arancio/bianco), 3 stopper Per tutti gli strumenti IC con pompa peristaltica	
6.1826.340	Tubo di pompaggio LFL (nero/nero), 3 stopper Per la soluzione campione nella dialisi in linea.	

6.1826.380 Tubo di pompaggio LFL (grigio/grigio), 3 stoppers
Per Inline Dilution



6.1826.390 Tubo di pompaggio LFL (giallo/giallo), 3 stopper
Per la soluzione campione nell'Inline Filtration.



6.2041.310 Rack dei campioni, 12 x 250 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 12 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.320 Rack dei campioni, 16 x 150 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 16 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: beaker in vetro da 150 mL (forma alta).

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.340

Rack dei campioni, 24 x 75 mL (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 24 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.350

Rack dei campioni, 48 x 75 mL (PVC)

Rack dei campioni per 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic" adatto a 48 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.210; 6.1459.400.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)




6.2041.360

Rack dei campioni, 12 x 150 mL (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 12 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: beaker in vetro da 150 mL (forma alta), 6.1459.310.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)

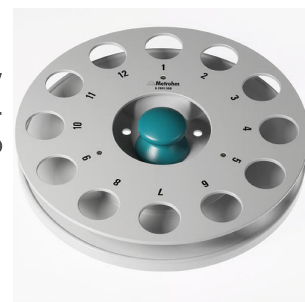


6.2041.370

Rack dei campioni, 14 x 200 mL (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 14 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.310.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)

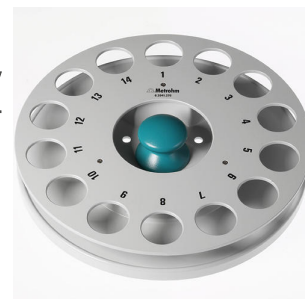

6.2041.380

Rack dei campioni, 14 x 235 mL (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 14 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 235 mL (8 oz.).

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.410

Rack dei campioni, 141 x 11 mL e 1 x 300 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic" adatto a 141 provette e 1 flacone per risciacquo. Possono essere utilizzati le seguenti provette e i seguenti flaconi per risciacquo: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.430

Rack dei campioni, 127 x 11 mL e 2 x 300 mL (PVC)

Rack dei campioni per 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic" adatto a 127 provette e 2 flaconi per risciacquo. Possono essere utilizzati i seguenti flaconi per risciacquo e le seguenti provette: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.440

Rack dei campioni, 148 x 11 mL e 3 x 300 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL adatto a 148 provette e 3 flaconi per risciacquo. Possono essere utilizzati i seguenti flaconi per risciacquo e le seguenti provette: 6.2743.050, 6.1608.080, 6.1627.000, 6.2743.040.


Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.450 Rack dei campioni, 56 x 11 mL e 56 x 50 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL adatto a 112 provette. Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, provette Sarstedt da 50 mL.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)

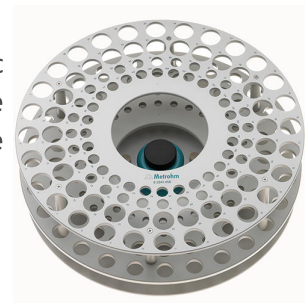

6.2041.760 Rack dei campioni 54 x 11 mL + 1 x 300 mL

Rack dei campioni con diametro piccolo per recipienti per campioni 54 x 11 mL in due file e 1 x bottiglia da 300 mL.



6.2148.010 Remote Box MSB

Interfaccia remote aggiuntiva per la connessione di strumenti che possono essere controllati tramite linee remote. Con cavi fissi permanenti.



6.2629.000 Dado per il supporto dell'ago IC

Per i Sample Processor.



6.2714.010

Membrana di dialisi (acetato di cellulosa)

Porosità nominale: 0.2 μm . Set di 50 pezzi. Per dialisi in linea



6.2714.020

Membrana di filtrazione in cellulosa rigen., 0,2 μm , 50 pz.

Grandezza nominale dei pori: 0,2 μm . Set da 50 pezzi. Per filtrazione in linea.



6.2714.030

Membrana di dialisi (poliammide)

Per la dialisi e la filtrazione in linea



6.2743.040

Vial PP, 2,5 mL, 2000 pezzi

2,5 mL. 2.000 pezzi. Per IC Sample Processors.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



6.2743.047 Vial PP, 2,5 mL, 200 pezzi

2,5 mL. 200 pezzi. Per IC Sample Processors.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



6.2743.057 Recipiente per campioni 11 mL

200 pezzi. Per IC Sample Processors e VA Autosampler.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



6.2743.070 Tappi perforati

2000 pezzi. Per IC Sample Processors



6.2743.077 Tappo con foro

200 pezzi. Per IC Sample Processors



6.5330.100

Equipaggiamento IC: dialisi in linea

Kit di accessori per dialisi in linea. Per l'utilizzo con l'858 Professional Sample Processor e un'ulteriore pompa peristaltica a 2 canali.



6.5330.120

Equipaggiamento IC: diluizione in linea

Kit di accessori per diluizione in linea. Per l'utilizzo con l'858 Professional Sample Processor, l'800 Dosino e il 741 Magnetic Stirrer.



6.5330.130

Equipaggiamento IC: Liquid Handling, sinistra

Kit di accessori per il montaggio della Liquid Handling Station sul Professional Sample Processor. L'alimentazione dell'acqua di lavaggio può essere assicurata dalla pompa peristaltica o dal Dosino.



6.5330.140

Equipaggiamento IC: MiPCT

Kit di accessori per arricchimento in linea (MiPCT) inclusa Liquid Handling Station, sinistra.



6.5330.160

Equipaggiamento IC: MiPCT-ME

Kit di accessori per il montaggio di un Dosino per la tecnica di arricchimento intelligente Metrohm con eliminazione della matrice (MiPCT-ME).



6.5330.170

Equipaggiamento IC: MiPuT

Kit di accessori per il montaggio di un Dosino per il pick-up di campioni (tecnica di iniezione intelligente pick-up di Metrohm).



6.5330.180

Equipaggiamento IC: MiPT

Kit di accessori per il montaggio di un Dosino per l'iniezione a loop parziale.



6.2624.200

Ago per campioni in acciaio, rivestito

Alternativa all'ago per campioni in ossido di zirconio. Particolarmente adatto per recipienti con setto. Senza metalli grazie allo speciale rivestimento. Necessita di supporto per ago 1/16 in. (6.2833.010) per il montaggio sul Sample Processor.



6.2846.010

Ago per campioni in ossido di zirconio con punta PEEK

Ago per campioni per Sample Processor e Autosampler nella cromatografia ionica. La punta in PEEK garantisce una foratura sicura della copertura del vial.



6.2041.780

Rack dei campioni 65 x 11 mL + 25 x 50 mL


Rack dei campioni a più file per 65 campioni in vial da 11 mL (6.2743.050) e 25 campioni in vial da 50 mL (6.02743.030)



6.2041.770

Rack dei campioni 211 x 11 mL

Rack dei campioni a più file con 211 campioni in recipienti per campioni da 11 mL (6.2743.050)

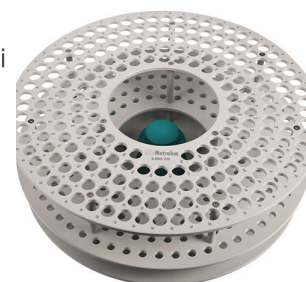

6.9920.255

Rack dei campioni 25 x 60 mL + 10 x 125 mL

Rack dei campioni a più file per 25 campioni in beute per coltura cellulare Corning® da 60 mL e 10 campioni in bottiglie in PE da 125 mL (6.1627.000). Rack dei campioni dedicato per analisi delle tracce, per esempio nella centrale elettrica.

