



863 Compact IC Autosampler

2.863.0010

L'863 Compact IC Autosampler è l'ausilio ideale per l'analisi di routine. Con esso è possibile automatizzare i vari cromatografi ionici della gamma Metrohm.

Parti incluse 2.863.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.863.0010	863 Compact IC Autosampler

L'863 Compact IC Autosampler è l'ausilio ideale per l'analisi di routine. Con esso è possibile automatizzare i vari cromatografi ionici della gamma Metrohm.



2 PCS

6.1826.360

Tubi di pompaggio LFL (bianco/bianco), 3 stopper

Per Sample Processors



1 PCS

6.1831.050

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 40 cm

Per dialisi in linea e per autocampionatori. Per IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact Autosampler



1 PCS

6.1831.060

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 1 m

Per dialisi in linea e per Sample Changers. Per IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



1 PCS

6.2151.100

Adattatore USB Mini (OTG) - USB A

Per la connessione di strumenti USB.



1 PCS

6.2151.110

Cavo USB, 1.8 m

For connecting USB instruments.



1 PCS

6.2621.090

Chiave inglese 1/2 in.

Per viti di fissaggio da 1/2 in. Per IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Chiave esagonale 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



1 PCS

6.2743.057

Recipiente per campioni 11 mL

200 pezzi. Per IC Sample Processors e VA Autosampler.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



1 PCS

6.2743.077

Tappo con foro

200 pezzi. Per IC Sample Processors



1 PCS

6.2744.034

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.



1 PCS

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.




1 PCS

6.2744.160

Accoppiatore/UNF 10/32 con dispositivo di sicurezza

Dispositivo di sicurezza per il collegamento di un tubo di pompaggio ad un ugello

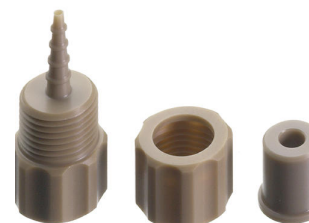

1 PCS

6.2833.030

Supporto per ago 1/8 poll. per 863 Compact Autosampler

Supporto per ago 1/8 poll. per 863 Compact Autosampler



1 PCS

6.2846.010

Ago per campioni in ossido di zirconio con punta PEEK

Ago per campioni per Sample Processor e Autosampler nella cromatografia ionica. La punta in PEEK garantisce una foratura sicura della copertura del vial.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1826.310	Tubo flessibile LFL (arancione/verde), 3 stopper Tubo di pompaggio per soluzioni del soppressore e per la soluzione accettore nella dialisi in linea e l'ultrafiltrazione in linea.	
6.1826.320	Tubo di pompaggio LFL (arancione/giallo), 3 stopper Per soluzioni del soppressore e per la soluzione accettore nella dialisi in linea e l'ultrafiltrazione in linea.	
6.1826.330	Tubi di pompaggio LFL (arancio/bianco), 3 stopper Per tutti gli strumenti IC con pompa peristaltica	
6.1826.340	Tubo di pompaggio LFL (nero/nero), 3 stopper Per la soluzione campione nella dialisi in linea.	

6.1826.380 Tubo di pompaggio LFL (grigio/grigio), 3 stoppers
Per Inline Dilution



6.1826.390 Tubo di pompaggio LFL (giallo/giallo), 3 stopper
Per la soluzione campione nell'Inline Filtration.



6.2141.230 Cavo remoto Compact Sample Changer/Compact Autosampler - Titrino
plus/Pump Station
Cavo per il collegamento remoto tra Compact Sample Changer/Compact
Autosampler e Titrino plus e/o Pump Station.



6.2141.270 Cavo Compact IC Autosampler - connessione remota a strumenti IC
Consente il comando dell'IC Autosampler tramite segnali remoti da altri
strumenti IC



6.2151.020

Cavo USB A - USB B 1.8 m

Cavo di collegamento USB



6.2629.000

Dado per il supporto dell'ago IC

Per i Sample Processor.



6.2723.310

Copertura protettiva per Titrino Plus

Copertura protettiva per display e keypad per tutti gli strumenti della famiglia Titrino plus.

Adatta per: 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF-Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus, 899 Coulometer.



6.2743.040

Vial PP, 2,5 mL, 2000 pezzi

2,5 mL. 2.000 pezzi. Per IC Sample Processors.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



6.2743.047

Vial PP, 2,5 mL, 200 pezzi

2,5 mL. 200 pezzi. Per IC Sample Processors.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



6.2743.050

Recipiente per campioni 11 mL

2000 pezzi. Per IC Sample Processors e VA Autosampler.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.

