




898 XYZ Sample Changer 48 x 250 mL

2.898.0210

L'898 XYZ Sample Changer convince per la velocità e il numero di campioni che possono essere trattati senza sorveglianza. Due rack dei campioni ciascuno con beaker da 24 x 250 mL possono essere posti sul Sample Changer ed elaborati in modo continuo. Non appena è stato trattato, il primo rack può essere sostituito con un rack di nuovi campioni. Grazie alla stazione di lavaggio incorporata con pompa a membrana, i sensori utilizzati sono sempre nello stato migliore. Il controllo avviene tramite PC con software di titolazione tiamo™.

Parti incluse 2.898.0210

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.898.0010	XYZ Sample Changer



2 PCS

6.1621.010

Contenitore in PE/30 L

Contenitore dell'eluente per gli apparecchi IC in linea.



5 PCS

6.1236.020

Giunto conico con SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm e O-ring



50 PCS

6.1432.320

Beaker per campioni in vetro trasparente da 250 mL,
1 pezzo

Beaker per campioni in vetro trasparente da 250 mL, adatto ai rack dei
campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820,
6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo



5 PCS

6.1446.000

Stopper SGJ / B-14/(15)



3 PCS

6.1446.010

Stopper

Da usare con Sample Changers



1 PCS

6.1458.010

Testa di titolazione, aperture 6 x SGJ 14 e 3 x SGJ 9

Con aperture 6xSGJ 14 e 3x SGJ 9.



2 PCS

6.1543.200

Punta di titolazione / filettatura M6

Punta di titolazione con valvola antidiffusione.



2 PCS

6.1621.110

Tappo per contenitore da 30-L

Tappo per contenitore da 30-L. Per un facile e sicuro trasporto dei contenitori riempiti.



2 PCS 6.1805.530 Tubo in FEP / M6 / 2 m
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



3 PCS 6.2709.070 Giunto guida
Per il fissaggio di burette e punte di dosaggio nelle teste di titolazione e supporti di elettrodi




1 PCS 6.6067.000 Chiave USB per 898 XYZ Sample Changer




1 PCS 6.2071.040 Rack dei campioni per 898 XYZ SC 24 x 250 mL
sinistra



Rack dei campioni per beaker da 24 x 250 mL (6.1432.320) per 898 XYZ Sample Changer. Il rack dei campioni dispone di un incavo per la stazione di lavaggio esterna ed è numerato con numeri da 1 a 24. Viene sistemato nella parte sinistra del campionatore. Per ogni 898 XYZ SC possono essere posizionati al massimo due rack dei campioni.



Rack dei campioni per beaker da 24 x 250 mL (6.1432.320) per 898 XYZ Sample Changer. Il rack dei campioni dispone di un incavo per la stazione di lavaggio esterna ed è numerato con numeri da 25 a 48. Viene sistemato nella parte destra del campionatore. Per ogni 898 XYZ SC possono essere posizionati al massimo due rack dei campioni



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2071.020	Rack dei campioni per 898 XYZ SC 41 x 120 mL a sinistra Rack dei campioni per beaker da 41 x 120 mL (6.1459.300) per 898 XYZ Sample Changer. Il rack dei campioni dispone di un incavo per la stazione di lavaggio esterna ed è numerato con i numeri da 1 a 41. Viene sistemato nella parte sinistra del campionatore. Per ogni 898 XYZ SC possono essere posizionati al massimo due rack dei campioni.	
6.2071.030	Rack dei campioni per 898 XYZ SC 41 x 120 mL a destra Rack dei campioni per beaker da 41 x 120 mL (6.1459.300) per 898 XYZ Sample Changer. Il rack dei campioni dispone di un incavo per la stazione di lavaggio esterna ed è numerato con numeri da 42 a 82. Viene sistemato nella parte destra del campionatore. Per ogni 898 XYZ SC possono essere posizionati al massimo due rack dei campioni.	
6.7600.010	Vasca di raccolta per 898 XYZ Sample Changer Vasca di raccolta per 898 XYZ Sample Changer.	
6.7600.020	Supporto stazione di lavaggio per 898 XYZ Sample Changer Supporto stazione di lavaggio per 898 XYZ Sample Changer.	

6.7600.030 Stazione di lavaggio per 898 XYZ Sample Changer

Stazione di lavaggio per 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.040 Guida per tubo flessibile per 898 XYZ Sample Changer

Guida per tubo flessibile per 898 XYZ Sample Changer



6.7600.050 Supporto per testa di titolazione per 898 XYZ Sample Changer

Supporto per testa di titolazione per 898 XYZ Sample Changer



6.7600.060 Protezione dagli schizzi per 898 XYZ Sample Changer

Protezione dagli schizzi per 898 XYZ Sample Changer



6.7600.070

Kit di lavaggio e aspirazione per 898 XYZ Sample Changer


Kit di lavaggio e aspirazione (FEP/TYGON) per 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.080

Kit di lavaggio con pompa a membrana per 898 XYZ Sample Changer

Kit di lavaggio con pompa a membrana per 898 XYZ Sample Changer.

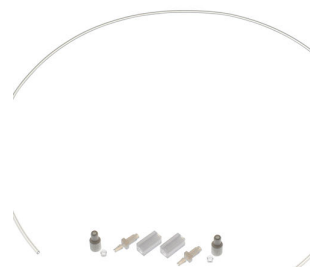

6.7600.090

Alimentatore da 24 Volt per 898 XYZ Sample Changer

Alimentatore da 24 Volt per 898 XYZ Sample Changer.

