


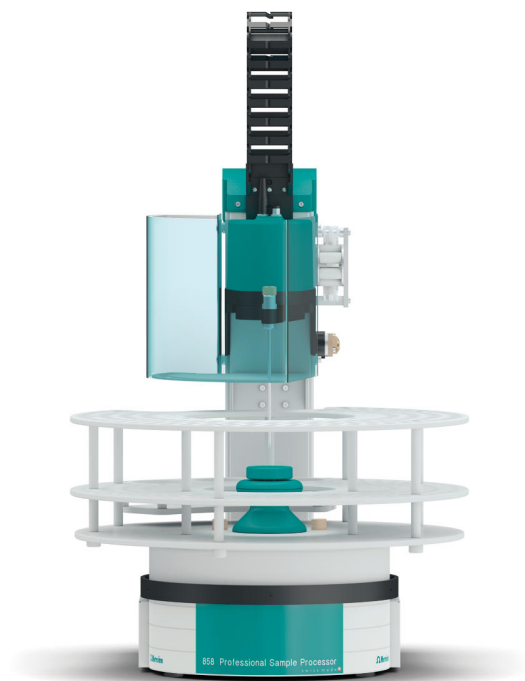

858 Professional Sample Processor – Pump – Injector

2.858.0030

858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ：ポンプ – インジェクター は、500 μ Lから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプもしくは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。更にサンプル前処理では、六方向注入バルブの使用が可能です。

納品範囲 2.858.0030

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.858.0030	858 Professional Sample Processor – Pump – Injector

858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ：ポンプ – インジェクター は、500 μ Lから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプもしくは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。更にサンプル前処理では、六方向注入バルブの使用が可能です。



3 PCS

6.1608.080

Bottle / 300 mL



1 PCS

6.1803.030


PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 3 m



1 PCS

6.1825.210

PEEK sample loop 20 µL



2 PCS

6.1826.360

Pump tubing LFL (white/white), 3 stoppers



1 PCS

6.1831.010

PEEK capillary 0.25 mm i.d. / 3 m



1 PCS

6.1831.060

PEEK capillary 0.5 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.1831.160

PEEK capillary, 0.5 mm ID / 70 cm



1 PCS

6.2064.000

Beaker retainer for Advanced IC Sample Processor



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.300

Tool set for Advanced IC Sample Processors



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



1 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



1 PCS

6.2744.070

Pressure screw short



1 PCS

6.2744.110


Pump tubing - inline filter PEEK adapter



2 PCS

6.2744.160


Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device

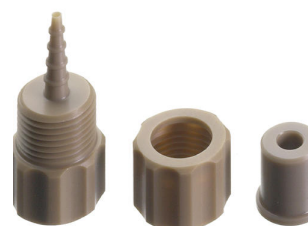

1 PCS

6.2751.110

Safety shield



1 PCS

6.2846.010

Sample needle made of zirconium oxide with
PEEK tip



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1826.310	Pump tubing LFL (orange/green), 3-stopper	
6.1826.320	Pump tubing LFL (orange/yellow), 3-stopper	
6.1826.330	Pump tubing LFL (orange/white), 3 stoppers	
6.1826.340	Pump tubing LFL (black/black), 3 stoppers	

6.1826.380 Pump tubing LFL (gray/gray), 3 stoppers



6.1826.390 Pump tubing LFL (yellow/yellow), 3 stoppers



6.2041.310 サンプルラック、12 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

12 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.320 サンプルラック、16 x 150 mL、(ポリ塩化ビニル製)

16 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.340 サンプルラック、24 x 75 mL、(ポリ塩化ビニル製)

24 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.350 サンプルラック、48 x 75 mL (ポリ塩化ビニル製)

48 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。


合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.360 サンプルラック、12 x 150 mL (ポリ塩化ビニル製)

12 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー)、6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

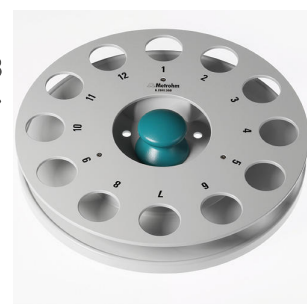

6.2041.370 サンプルラック、14 x 200 mL、(ポリ塩化ビニル製)

14 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.380 サンプルラック、14 x 235 mL (ポリ塩化ビニル製)

14 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 235 mL (8オンス)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.410 サンプルラック、141 x 11 mL および 1 x 300 mL、(ポリ塩化ビニル製)

141 個のサンプル容器および1個のリンスボトルのための858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.430 サンプルラック、127 x 11 mL および 2 x 300 mL (ポリ塩化ビニル製)

127 個のサンプル容器および2個のリンスボトルに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。


合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.440 サンプルラック、148 x 11 mL および 3 x 300 mL、(ポリ塩化ビニル製)

148 個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

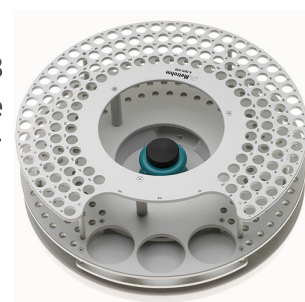

6.2041.450 サンプルラック、56 x 11 mL および 56 x 50 mL、(ポリ塩化ビニル製)

112 個のサンプル容器に適した 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 6.2743.050、6.2747.010、6.2743.040、50 mL ザールシュテット サンプル瓶。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.760 Sample rack 54 x 11 mL + 1 x 300 mL



6.2148.010 Remote Box MSB



6.2629.000 Screw nut to needle holder IC





6.2714.020 再生セルロース製ろ過膜 0.2 μm 、50 枚入

公称気孔径: 0.2 μm 。50 枚セット。インライン限外ろ過用。



6.2714.030 Dialysis membrane (polyamide)



6.2743.040 PP バイアル、2.5 mL、2000 個

2.5 mL。2000 個。IC Sample Processors 用。
ICサンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および梱包は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



6.2743.047 PP バイアル、2.5 mL、200 個

2.5 mL。200 個。IC Sample Processors 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



6.2743.057 サンプル容器 11 mL

200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



6.2743.070 Stopper with perforation



6.2743.077 Stopper with perforation



6.5330.100 ICアクセサリ: インライン透析

インライン透析のための付属品セット。858 プロフェッショナルサンプルプロセッサおよび追加の2チャンネルタイプのペリスタリックポンプとの併用に。



6.5330.120 ICアクセサリ: インライン希釈

インライン希釈のための付属品セット。858プロフェッショナルサンプルプロセッサ、800 ドジーノ電動ビュレット、741 マグネチックスターラとの併用に。



6.5330.130 ICアクセサリ: リキッドハンドリングステーション(左)

プロフェッショナルサンプルプロセッサのリキッドハンドリングステーションの設置のための付属品セット。洗浄水の供給はペリスタリックポンプもしくはドジーノ電動ビュレットによって行われます。



6.5330.140 ICアクセサリ: MiPCT

リキッドハンドリングステーション（左）を含むインライン濃度調整 (MiPCT) 用の付属品セット。



6.5330.160 ICアクセサリ: MiPCT-ME

マトリックス除去 (MiPCT-ME) 機能を備えたメトロームインテリジェント濃度調整技術のドジーノ設置のための付属品セット。



6.5330.170 IC機器: MiPuT

サンプルピックアップのドジーノ設置のための付属品セット (メトロームのインテリジェントピックアップインジェクション技術)。



6.5330.180 ICアクセサリ: MiPT

パーシャルループインジェクションのドジーノ設置のための付属品セット。



6.2624.200 Sample needle made of steel, coated



6.2846.010


Sample needle made of zirconium oxide with PEEK tip



6.2041.780


サンプルラック 65 x 11 mL + 25 x 50 mL

11 mL サンプル容器入りのサンプル65個分 (6.2743.050) および50 mL サンプル容器入りのサンプル25個分 (6.02743.030) のための複列サンプルラック



6.2041.770

サンプルラック 211 x 11mL

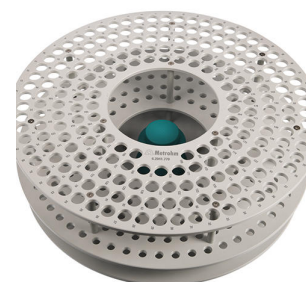

6.9920.255

サンプルラック 25 x 60 mL + 10 x 125 mL

60 mL Corning®-細胞培養フラスコ 25 サンプルおよび125 mL PEボトル 10 サンプル用複列サンプルラック (6.1627.000)。発電所等における微量分析用サンプルラック。

