


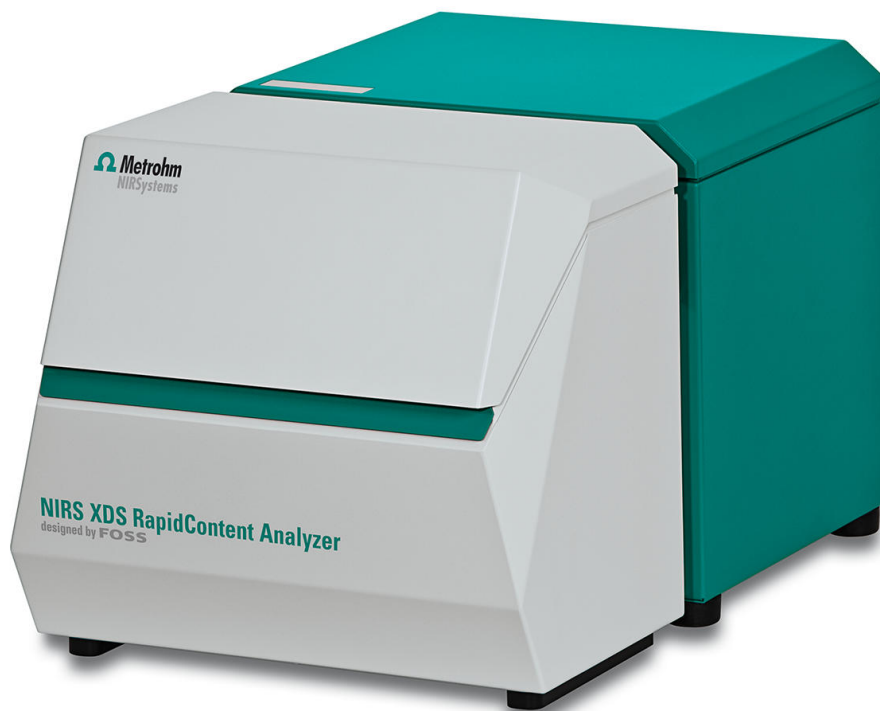

NIRS XDS RapidContent Analyzer – Solids

2.921.1120

固形、液状物質の迅速な非破壊分析

NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solidsにより、固形粉末、粗粒、ペレット、薄片物質を迅速に非破壊分析することができます。

原料測定や構成成分の調査は、ラボもしくは、サンプルその原料測定や構成成分の調査は、サンプルのオリジナルパッケージや袋、またはバイアル内で、ラボまたはアットラインで実施されます。オプションで設定可能なドットサイズにより、サンプルの物理的特徴に合わせてサンプル照明を調整することができます。

液状サンプルのためのNIRSトランスフレクションキット(注文番号: 6.7400.010)の導入によって、液状サンプルの測定がスムーズに実行できます。

NIRS XDS Iris(注文番号: 6.7425.000)を用いるとサンプルのセンタリングが行われ、それによって分析の再現性を高めることができます。

NIRS XDS RapidContent Analyzerは、X軸方向への可動性の統合型サンプルスライドにより、より多くの量の不均一なサンプルを分析することができます。

納品範囲 2.921.1120

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.921.0010	NIRS XDS Monochromator
		
1 PCS	1.921.0120	NIRS XDS RapidContent Solids Module
		
1 PCS	6.7400.000	NIRS XDS accessory kit
		
1 PCS	6.7425.000	NIRS XDS Irisアダプター
NIRS XDS RCA Analyzer、NIRS XDS MasterLab Analyzer、NIRS XDS MultiVial Analyzerにおける小さいサンプル容器、Reflection standard、様々なバイアル、またはTransflexion容器などの焦点合わせのためのIrisアダプター 		



サンプルモジュールによるモノクロメーターのキャリブレーションには、反射基準が必要となります。

キャリブレーション基準の固定には、その中にスタンダードを設置するホルダーを使用します。

リフレクションスタンダードおよびそれに付属するホルダーは、以下のものに必要となります：

- NIRS XDS MultiVial Analyzer（注文番号: 29211210）
- NIRS XDS MasterLab Analyzer（注文番号: 2.921.1310）



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.7402.020	6.7402.030 のための NIRS 使い捨てのフタ、100個 使い捨てのフタは、小さいサンプル容器を確実に密閉するために使用されます。以下の機器にサンプルガラス容器が使用されます: • NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010) • NIRS XDS Masterlab Analyzer (注文番号: 2.921.1310) • NIRS XDS RCA Analyzer (注文番号: 2.921.1110) • NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1210) パッケージは100個の使い捨てのフタから構成されます。
6.7402.030	NIRSトランスフレクション容器、小、10個(使い捨てのフタ100個付き) 反射中の粉末や粗粒状物質のスペクトル記録のための小さなサンプル容器。サンプル容器はサンプルの紛失を避けるために、またサンプル容器内での粉末や粗粒状物質の分散が均一になるように、使い捨てのフタで閉じることができます。 以下の装置においてはサンプルガラス容器が使用されます: • NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010) • NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310) • NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120) • NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110) • NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)
6.7430.010	実験装置用 NIRS XDS 交換部品 実験装置用 NIRS XDS 交換部品は、交換ランプ 2 個、ファンフィルター 2 個、ヒューズ 4 個で構成されています。



6.7430.000 NIRS XDS lab spare lamp



6.7450.000 NIRS reflection standard, set of 2



6.7450.010 NIRS reflection standard, set of 7



6.7400.010 液体サンプルのためのNIRSトランスフレクションキット

NIRS Liquid Sample Kit Transflectionにより、以下の装置における液体のトランスフレクション測定機能を拡張することができます:

- NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)



Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
- 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース

バージョン Vision Air Complete (66072208) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

その他の Vision Air Complete ソリューション:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Network は操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。ネットワークバージョンでは、セントラルデータバンクを伴うグローバルなサーバークライアントネットワークの構築が可能となります。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 一元化されたデータ管理および装置管理
- 少ない手順で複数の装置を容易にコンフィグレーション、アップデート

バージョン Vision Air Network Complete (66072207) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- グローバルな装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Pharma Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
- 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース
- Title 21 CFR Part 11の全ての要求を満たします。

バージョン Vision Air Pharma Complete (66072209) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Pharma Network Complete は操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。ネットワークバージョンでは、セントラルデータバンクを伴うグローバルなサーバークライアントネットワークの構築が可能となります。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 一元化されたデータ管理および装置管理
- 少ない手順で複数の装置を容易にコンフィグレーション、アップデート
- Title 21 CFR Part 11の全ての要求を満たします。

バージョン Vision Air Pharma Network Complete (66072210) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- グローバルな装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

液体のスペクトル測定のためのオプティカルフラットのトランスフレクション容器。以下の装置との組み合わせが可能です:

- NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)



6.7420.000 NIRS 金製リフレクター、全層厚1 mm

液体のトランスフレクション測定のための金製リフレクタ。以下の装置との組み合わせが可能です:

- NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)



6.7420.010 NIRS 金製リフレクター、全層厚2 mm

液体のトランスフレクション測定のための金製リフレクタ。以下の装置との組み合わせが可能です:

- NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)
- NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)
- NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)
- NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)



6.7420.020 NIRS 金製リフレクター、全層厚4 mm

液体のトランスフレクション測定のための金製リフレクター。以下の装置との組み合わせが可能です:

NIRS DS2500 Analyzer (注文番号: 2.922.0010)
NIRS XDS MasterLab Analyzer (注文番号: 2.921.1310)
NIRS XDS MultiVial Analyzer (注文番号: 2.921.1120)
NIRS XDS RapidContent Analyzer (注文番号: 2.921.1110)
NIRS XDS RapidContent Analyzer - Solids (注文番号: 2.921.1210)



6.7430.060 マイクロファイバー製クリーニングクロス

モニターおよびレンズ用クリーニングクロス。



6.7402.110 使い捨てバイアル、15 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 15mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 123 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.120 使い捨てバイアル、19 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 19mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 225 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.130 使い捨てバイアル、22 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 22mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 172 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS
の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.140 使い捨てバイアル、28 mm、反射

反射された固形物を分析するための直径 28mm の密封可能なガラス製
使い捨てバイアル 216 個。以下のアナライザーに適しています:

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer



6.7402.220 6.7402.130 のための流出防止ストッパー

使い捨てバイアル 22 mm 反射のための流出防止ストッパー172個。



6.7402.230 6.7402.140 のための流出防止ストッパー

使い捨てバイアル 28 mm 反射のための流出防止ストッパー216個。



6.7402.200 6.7402.110 のための流出防止ストッパー

使い捨てバイアル 15 mm 反射のための流出防止ストッパー123個。



6.7402.210 6.7402.120 のための流出防止ストッパー

使い捨てバイアル 19 mm 反射のための流出防止ストッパー225個。

