


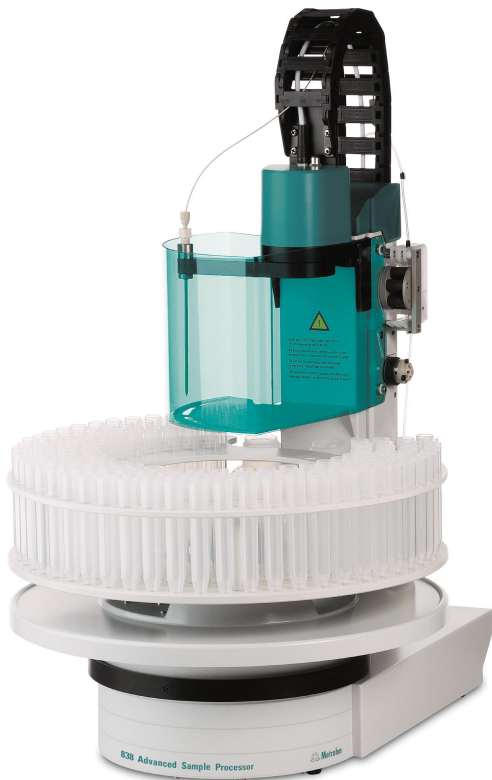

万思得进样器型离子色谱样品处理系统

2.838.0020

万思得IC样品处理器，带六通进样器，可用于需要附加一个进样器的分析应用。

Scope of delivery 2.838.0020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.838.0020	万思得进样器型离子色谱样品处理系统 万思得IC样品处理器，带六通进样器，可用于需要附加一个进样器的分析应用。




3 PCS 6.1608.080 试剂瓶 / 300毫升

IC样品处理器的冲洗瓶



1 PCS 6.1825.210 PEEK样品环, 20 µL

用于进样阀, 带2只PEEK压力螺丝



1 PCS 6.1831.010 PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米 / 3 米

用于所有IC 元件。



1 PCS 6.1831.050 PEEK 毛细管, 内径0.5 毫米, 40厘米

用于在线英蓝渗析与样品转换器。用于IC英蓝渗析单元, 离子色谱样品处理系统, 集成型自动样品处理系统, 英蓝渗析型离子色谱样品处理系统, IC液体处理英蓝渗析单元, 集成型自动样品处理系统



2 PCS

6.1831.060

PEEK 毛细管, 内径0.5 毫米, 1 米

用于在线渗析与样品转换器。用于IC渗析单元, IC样品处理器, 紧凑型IC自动进样器, 过滤型IC样品处理器, 渗析型IC样品处理器, IC液体处理渗析单元



1 PCS

6.2064.000

万思得IC样品处理器烧杯截留器

838万思得样品处理器样品管截留板 (retaining plate)。可放2.5或11毫升样品管。



1 PCS

6.2134.100

电缆 / 5 米 / RS232 DB9 - IBM-PC (DB9)

用于连接瑞士万通RS232接口 - Titrino, 756卡尔费休库仑水份测定仪, 762或771型IC接口, 790 Personal IC



1 PCS

6.2141.190

电缆, 732/819-766/788/838

电缆, IC检测器-万思得样品处理器



1 PCS 6.2621.300 万思得IC样品处理器的工具套件
工具套件，包括开口扳手和六角扳手（Hexagon key）。



1 PCS 6.2739.000 扳手
用于拧紧连接器



1 PCS 6.2744.010 压力螺丝5x
带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



1 PCS 6.2744.034 2 个 Olive/UNF 10/32 两通
连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



1 PCS

6.2744.110

泵管 – 英蓝过滤器 PEEK (聚醚醚酮) 适配器

泵管和英蓝过滤器之间的连接件




1 PCS

6.2744.160

连接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置

安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。




1 PCS

6.2751.110

安全盖板

用于高级 IC/VA 样品处理器的安全盖板。



2 PCS

6.1826.360

泵管 LFL (白色/白色)，三个堵头

用于样品处理器



用于离子色谱分析中的样品处理器和 Autosampler。PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管确保能穿透瓶盖。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1562.130	移液软管，带固定器，2 x M6 / 10毫升，用于样品处理器 移液管，用于由万思得离子色谱样品处理系统上的 Dosino 多思 数字计量瓶顶加液器进行的稀释和预浓缩	
6.2041.310	样品架，12 x 250 mL，（聚氯乙烯） 与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。 塑料：聚氯乙烯 (PVC)	
6.2041.320	样品架，16 x 150 mL，（聚氯乙烯） 与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 16 个样品杯。可使用以下样品杯：150 mL 大口杯（高形状）。 塑料：聚氯乙烯 (PVC)	
6.2041.340	样品架，24 x 75 mL，（聚氯乙烯） 与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.210、6.1459.400。 塑料：聚氯乙烯 (PVC)	

6.2041.350 样品架, 48 x 75 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 48 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210; 6.1459.400。


塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.360 样品架, 12 x 150 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯: 150 mL 大口杯 (高形状)、6.1459.310。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.370 样品架, 14 x 200 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 14 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.310。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.380 样品架, 14 x 235 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 14 个样品杯。以下样品杯均可使用: 235 mL (8 oz.)。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.430 样品架, 127 x 11 mL 和 2 x 300 mL (聚氯乙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 127 个样品容器和 2 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.440 样品架, 148 x 11 mL 和 3 x 300 mL, (聚氯乙烯)

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL 适配的样品架, 用于 148 个样品容器和 3 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.450 样品架, 56 x 11 mL 和 56 x 50 mL, (聚氯乙烯)

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL 适配的样品架, 用于 112 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2743.050、6.2747.010、6.2743.040、50 mL Sarstedt 小管。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.760 样品架 54 x 11 mL + 1 x 300 mL

较小直径的样品盘, 用于排成两排的 54 x 11 mL 样品容器及附加的 1 x 300 mL 样品瓶



6.2629.000 IC 针架的螺母

用于 Sample Processor。



6.2743.040 PP 小管, 2.5 mL, 2000 只

2.5 mL, 2000 只。用于 IC Sample Processors。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.047 PP 小管, 2.5 mL, 200 只

2.5 mL。200 个。用于 IC Sample Processors。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.050 样品容器 11 mL

2000 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.057 样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.070 塞子，其上有穿孔

2000只。用于IC样品处理器



6.2743.077 塞子，其上有穿孔

200只。用于IC样品处理器

