



Eco KF Titrator 用 KFT 配备

6.05610.050

完整的附件组，用于容量式卡尔·费休滴定法

Scope of delivery 6.05610.050

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1903.020	搅拌子 / 16 毫米 带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度： 16 毫米



1 PCS

6.1903.030

搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.00346.100

双 Pt 环形电极，用于容量分析

卡尔·费休滴定法用指示电极，由于具有两个熔融在一起的铂环，比传统铂销电极 (6.0338.100) 更坚固，更易于清洗。




1 PCS

6.01406.010

带盖子的吸附管

带盖子的吸附管，用于 OMNIS 容量式卡尔·费休水分测定仪

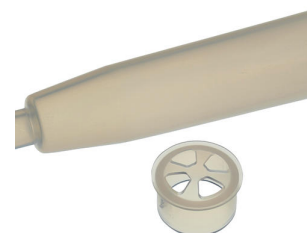

1 PCS

6.01406.220

20 – 90 mL 滴定杯

用于 6014050X0 滴定杯上部的带有螺旋塞的 20 – 90 mL 滴定杯。



1 PCS

6.01408.010

卡尔·费休滴定杯的密封套件

完整的密封套件，适用于 6.05609.000 和 6.05609.010。



1 PCS

6.01543.120

防扩散喷头

带防扩散阀门的滴定头，适用于 OMNIS 卡尔·费休水分测定仪。



3 PCS

6.02709.010

塞子

塑料材质的塞子，适用于 OMNIS 卡尔·费休水分测定仪 2.1001.4220。



1 PCS

6.02709.020

隔塞

塑料材质的隔塞，适用于滴定杯上部 6014050X0。



2 PCS

6.02709.030

螺旋接头

塑料材质的螺旋接头，适用于滴定杯上部 6014050X0。



1 PCS

6.02801.000

用于吸附管的棉花

棉花材质的棉棒（4 根），适用于 OMNIS 吸附管 601406010。



2 PCS

6.1448.010

垫片，12毫米，5片

每套5件。



2 PCS

6.2816.020

注射器，10毫升，带Luer接头。

用于许多种 IC 及 VA 应用



2 PCS

6.2816.030

带 Luer 式接头的针头

用于在多模式电极中加注水银的针头和用于在卡尔·费休滴定法中添加样品的针头。



1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.01405.050

Eco 滴定杯上部，用于容量式卡尔·费休滴定法

滴定杯上部，用于通过一个 Eco KF Titrator 进行容量式卡尔·费休滴定法滴定



Optional accessories

Order no.	Description
6.02709.040	螺旋塞 滴定杯上部螺旋塞 6014050X0。 
6.02711.000	刮样匙 适用于卡尔·费休法进行糊状物质的水份测定，例如：蜂蜜、化妆品、脂肪或各种乳制品。 刮样匙方便添加粘性样品。操作起来和其他铲子一样简单，并且有助于方便、快速和无损失地将膏剂添加到卡尔·费休滴定杯中。 为快速、完全地溶解粘性样品，我们另外建议使用匀浆器。 与滴定杯上部 6014050X0 匹配。 
6.2811.000	分子筛 分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。 
6.2811.010	分子筛（美国） 分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小：0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。 本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。 