


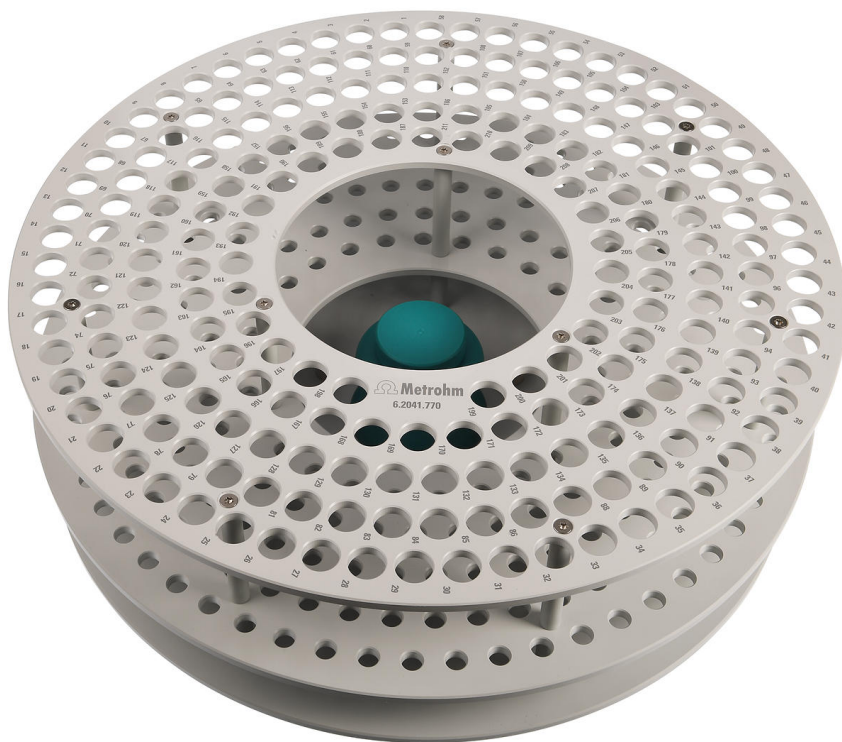

样品架 211 x 11mL

6.2041.770

用于 211 个分别 11 mL 样品容器 (6.2743.050) 的多排样品架

Optional accessories

Order no.	Description
6.2743.040	PP 小管，2.5 mL，2000 只
	2.5 mL，2000 只。用于 IC Sample Processors。 IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.047 PP 小管, 2.5 mL, 200 只

2.5 mL。200 个。用于 IC Sample Processors。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.050 样品容器 11 mL

2000 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.057 样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.070 塞子, 其上有穿孔

2000只。用于IC样品处理器



6.2743.077 塞子，其上有穿孔
200只。用于IC样品处理器



6.2841.120 灵快量化液体处理台，左侧

组合式冲洗和稀释台，用于带摆头（Swinghead）的自动进样器。用于安装在塔左侧。



6.2841.130 灵快量化液体处理台，右侧

组合式冲洗和稀释台，用于带双塔和摆头（Swinghead）的自动进样器。用于安装在塔右侧。



6.5330.130 离子色谱装备：LQH 灵快量化液体处理台，左侧

用于在 Professional Sample Processor 上安装 LQH 的附件组。冲洗供水可通过蠕动泵或 Dosino 完成。

