


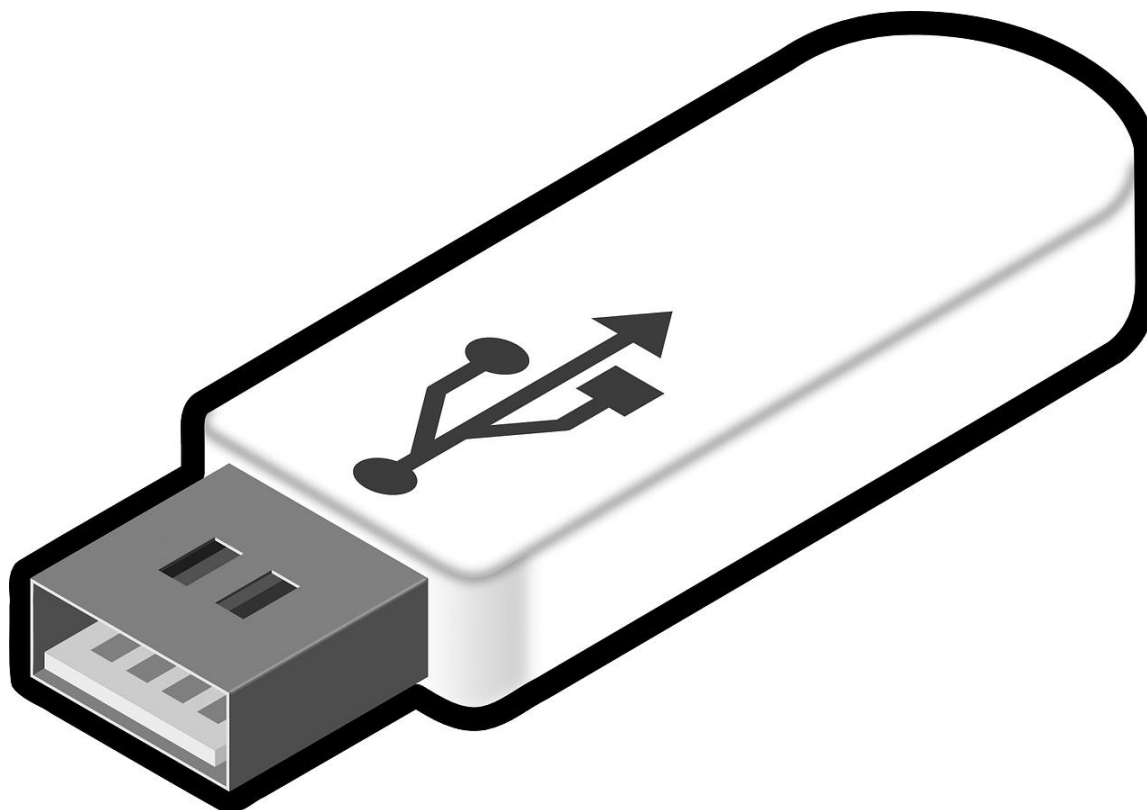

Metrohm IC Driver 1.0, ICP-MS MassHunter

6.6090.100

用于将 Metrohm IC 仪器集成到 5.3 和更高版本 Agilent`s ICP-MS MassHunter 软件中的驱动程序。

了解更多有关 IC 和质谱仪耦合的信息

Optional accessories

Order no.	Description
6.2148.010	远程盒, MSB 另外的远程接口, 用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的电缆。



6.05330.400

离子色谱与安捷伦ICP-MS的连接线套装

用于连接和双向控制 Metrohm IC 及 Agilent ICP-MS (IC-ICP/MS) 的离子色谱渗析装备

